

Federaal Platform COVID-19 Collectiviteiten



Versie van toepassing in de maand november

Inhoudstafel

1. Inleiding	3
2. Data stroom.....	4
2.1. Collectiviteitentool	4
2.2. Samenwerking met het Federaal Platform (huidige situatie)	5
2.3. Samenwerking met een partnerlaboratorium van het federaal platform	5
2.4. Consulteren van de resultaten	6
3. Logistieke stroom	6
4. Testmateriaal.....	7
5. Contact	8
Annex 1	9

Versie van toepassing in de maand november


Versie 1.1

5 november 2020

1. Inleiding

Gezien het langdurige karakter van de coronacrisis en dus de continuïteit van de testcapaciteit blijvend te garanderen (en zelfs te verhogen) werd er beslist om een “Platform BIS”, zeg maar federaal testplatform COVID-19 op te richten. Het federaal platform “Platform BIS” bestaat uit 8 consortia, elk consortium omvat een universitair laboratorium en een laboratorium voor klinische biologie dat verbonden is aan de universiteit:

- UGent en UZGent
- UAntwerpen en UZA
- KU Leuven en UZ Leuven
- ULiège en CHU Liège
- UNamur en CHU-UCL Namur
- UMons en Jolimont
- ULB en IBC
- UCL en Saint-Luc Bruxelles

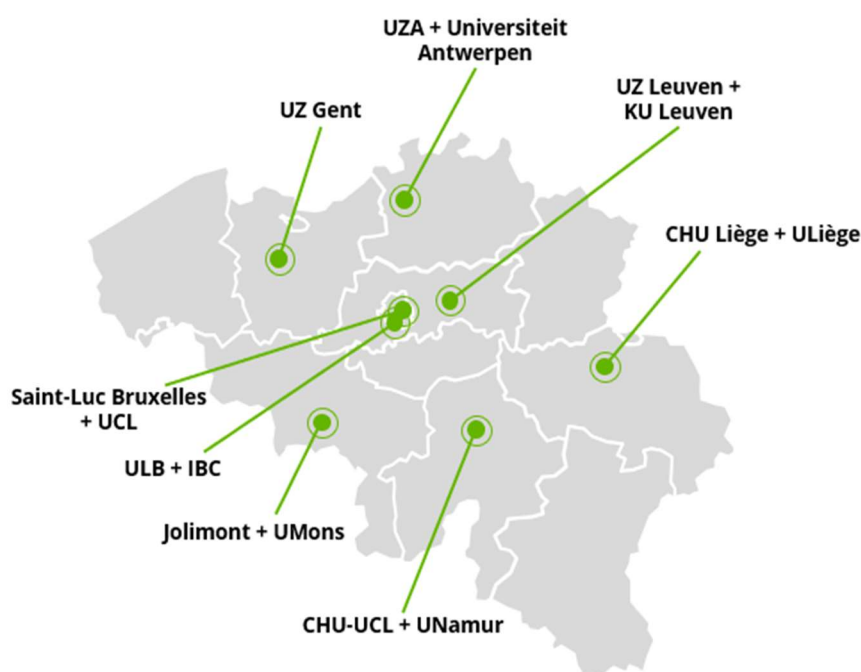

Op termijn zal elke labo partner tot 7 000 stalen per dag kunnen verwerken. Deze capaciteit wordt in de loop van de maand november en december uitgebouwd waardoor uiteindelijk een capaciteit van 56 000 stalen per dag bereikt wordt op het federale platform COVID-19.

De opschaling van de capaciteit zal gefaseerd verlopen. Samen met de klassieke klinische labo’s geeft dit volgende evolutie van de capaciteit:

	19/okt	26/okt	2/nov	9/nov	16/nov	23/nov	30/nov	7/dec	14/dec	21/dec	28/dec	4/jan	11/jan	18/jan
Klassieke klinische labo's	55000	55000	55000	57750	57750	60000	60000	60000	62500	62500	65000	65000	65000	65000
Federaal platform	15800	16800	17770	21100	26500	32800	31500	38500	42500	45500	47000	49500	49500	49500
TOTALE CAPACITEIT BE	70800	71800	72770	78850	84250	92800	91500	98500	105000	108000	112000	114500	114500	114500

Figuur 1: Evolutie van de testcapaciteit in België (op 28/10/2020)

2. Data stroom

In de collectiviteiten, kan u gebruikmaken van de “Collectiviteiten tool” (<https://www.corona-tracking.info/wp-content/uploads/2020/10/Voorschrijftool-Manual-NL.pdf>)



2.1. *Collectiviteitentool*

Via de WebApp Corona Test Prescription & Consultation (<http://pcr.tracing-coronavirus.be/>), kunnen de verantwoordelijke artsen :

- Aanvragen van een COVID-testvoorschrift voor personen in een collectiviteit of bedrijf ;
- Aanvragen van testen bij een laboratorium ;
- Bekijken van alle verzoeken van patiënten en resultaten die verbonden zijn aan zijn / haar collectiviteit / bedrijf.

Als verantwoordelijke arts heeft u toegang tot één of meerdere collectiviteiten / bedrijven. Om dit te doen, moet u een verklaring op eer afleggen om aan te geven dat u daadwerkelijk voor deze collectiviteit / onderneming werkt.

Als arbeidsgeneesheer / arts van een collectiviteit, kan u een administratief persoon (burger) een mandaat geven om u bij te staan bij de COVID-19 testaanvragen via de toepassing “mandaten” van de Federale Overheidsdienst Financiën: <https://eservices.minfin.fgov.be/mandates/healthcare/>.

Om een voorschrift aan te vragen, moet u alle nodige patiëntgegevens invullen, alsook de gegevens van de arts(en) die het resultaat / de resultaten moet(en) ontvangen.

Om een analyse aan te vragen (voor een bepaalde collectiviteit / onderneming), moet u de nodige gegevens invullen.

Bij de stalingave blijft het een absolute verplichting om de barcode van het staalnummer in te geven, alsook het labo te selecteren waar de stalen geanalyseerd zullen worden

2.2. Samenwerking met het Federaal Platform (huidige situatie)

Wanneer u met het federale platform werkt, moet u “FEDERAL-PLATFORM” selecteren.

Selecteren van het federale platform in de collectiviteitentool

Demander une analyse

CORONA
TEST PRESCRIPTION & CONSULTATION

Récapitulatif

Code prescription
Nom
N° registre national
N° de téléphone
Date de création

Laboratoire exécutant l'analyse *

Rechercher

Je veux que ma demande d'analyse soit exécutée par FEDERAL-PLATFORM

Type d'échantillon *

N° d'échantillon * Date de prélèvement * 28/10/2020 Heure du prélèvement *

Je ne dispose pas d'un numéro d'échantillon.

Type de test *
PCR

Envoyer

Als één van de gegevens niet wordt ingevuld, wordt de test niet geanalyseerd en ontvangt u de resultaten niet.

Als u de codes handmatig invoert, is het zeer belangrijk dat u controleert of de juiste barcode is ingevoerd.

2.3. Samenwerking met een partnerlaboratorium van het federaal platform

Van zodra de laboratoria de door Sciensano uitgevoerde audit succesvol doorstaan hebben, begint de uitrol. Dit gebeurt stap voor stap met een triagecentrum in de buurt. In de loop van de maand november 2020, en rekening houdend met de toename van nieuwe laboratoria, krijgen alle triagecentra die met het federaal platform werken een laboratorium in de buurt toegewezen (zie kaart hierboven). De omschakeling voor de collectiviteiten zal op een later tijdstip plaatsvinden.

- Het platform.bis labo of een medewerker van het huidige federaal platform met u contact opnemen.
- Er wordt vervolgens een overleg opgezet om praktische afspraken te maken. Tijdens het overleg worden onder meer de volgende elementen besproken:
 - Akkoord over effectieve startdatum;
 - Bevestiging openingsuren van uw triagepost en bijgevolg de gewenste ophaalmomenten;
 - Afstemming praktische modaliteiten (bijv. type box.).

Als u met een specifiek laboratorium werkt, moet u het laboratorium selecteren in module 3 van de collectiviteitentool (voor de collectiviteiten). Op die manier wordt het e-formulier direct naar het geselecteerde laboratorium gestuurd.

Als één van de gegevens niet wordt ingevuld, wordt de test niet geanalyseerd en ontvangt u de resultaten niet.

Als u de codes handmatig invoert, is het zeer belangrijk dat u controleert of de juiste barcode is ingevoerd.

The screenshot shows the 'E-Form Laboratory Test Request' interface. It is divided into sections: 'Info', 'Patiënt', and a 'Verstuur E-Form' button at the bottom. The 'Info' section includes fields for 'Labo *' (filled with 'fedel'), 'Voorschrijver *' (with a dropdown menu showing 'FEDERAL-PLATFORM | null'), 'Uitvoerder *' (with a placeholder 'Voornaam naam dokter'), and 'Ontvangers' (with a placeholder 'Voornaam naam dokter' and a note 'Geen ontvangers geselecteerd'). The 'Patiënt' section includes fields for 'Naam *' (filled with 'TESTo'), 'Voornaam *' (filled with 'testo'), 'Rijksregisternummer *' (with a placeholder 'xx.xx.xx-xx.xx'), 'Geslacht' (with radio buttons for 'Man' and 'Vrouw'), and 'GSM-nummer *' (with a placeholder 'GSM-nummer').

2.4. Consulteren van de resultaten

Het labo verwerkt de informatie van de e-form en koppelt de testresultaten rechtstreeks terug naar de personen die vermeld staan bij de ontvangers.

Uw dashboard geeft u een overzicht van uw aanvragen en resultaten.

Gelieve er rekening mee te houden dat :

- De informatie die zichtbaar is in het dashboard beperkt is tot 14 dagen in het verleden;
- Het dashboard toont alleen de laatste informatie per patiënt. De koerier neemt contact met u op om het tijdstip van levering (en afhaling) op elkaar af te stemmen.

3. Logistieke stroom

De centrale labo's (CERBA en PPD) zorgen voor de levering en de afhaling van de uitgevoerde testen. De procedure voor het aanvragen van tests via de contactpunten in de regio's verandert momenteel niet.

- Levering:
 - Wij organiseren de levering van het testmateriaal, evenals de levering van het beschermingsmateriaal.

- De levering vindt uiterlijk de dag voor de test plaats. De koerier neemt contact met u op om het tijdstip van levering (en afhaling) af te spreken.
- Afhaling:
 - Het centrale labo / de koerier neemt contact met u op om de meest geschikte tijd(en) voor afhaling af te spreken.
 - Het is belangrijk om alle stalen aan de koerier mee te geven op het moment van de afhaling. Daarnaast moeten de stalen geregistreerd zijn in de reserveringstool – idealiter op het moment afgenomen.

Informatie die u moet verstrekken:


- Exacte adres voor de levering en afhaling van de tests .
- Contactgegevens van het (de) contactpunt(en) van de collectiviteit

Let op : een verandering (andere logistieke partners) staat gepland voor december 2020, meer informatie zal worden meegedeeld in de maand november.

4. Testmateriaal

Het federaal platform werkt al sinds mei met een geïnactiveerd transportmedium (Zymo). Dit medium zal verder gebruikt worden. De tubes waarin het medium zit kunnen variëren naargelang het aanbod op de markt. Vanaf begin november zullen effectief nieuwe tubes in omloop komen van de firma Diagenode (zie figuur 2). Het specifieke met deze tubes is dat een dop slechts één keer gebruikt kan worden. De procedure voor staalafname blijft dezelfde, echter na staalafname dient de oorspronkelijke dop (oranje kleur) vervangen te worden door de secundaire dop (groene kleur) die meegeven wordt in de testkit. Het is belangrijk deze dop goed vast te draaien. **Gelieve de instructiefiche te consulteren.** (Zie instructiefiche in annex)

Figuur 2 : nieuwe tube



Het format van de barcodes is het volgende: CVxxxxxxCC waarbij x een cijfer (0-9) is en CC het controlecijfer.

Als u de codes manueel ingeeft, is het van groot belang dat u steeds controleert dat de exacte weergave van de barcode werd ingegeven.

Let op : Er mogen geen persoonlijke gegevens op de tubes worden aangebracht.

Het federaal platform kan zowel nasopharyngeale wissers (neuswissers) als oropharyngeale (keelwissers) aanleveren. Gelieve hiermee rekening te houden bij de staalafname!

5. Contact

Voor alle vragen met betrekking tot de COVID-19 testing via het federale platform, kan u terecht op:

- De handleiding met betrekking tot de collectiviteitentool : <https://www.corona-tracking.info/wp-content/uploads/2020/10/Voorschrijftool-Manual-NL.pdf>
- De gerelateerde webinars zijn beschikbaar op : <https://www.corona-tracking.info/webinars/>
- Voor frequently asked questions : <https://www.corona-tracking.info/artsen-collectiviteiten/federaal-platform/faqs/>

Voor andere vragen met betrekking tot de COVID-19 testing via het federale platform, kan u terecht op:

0800 980 06
02 223 00 00
tech@memo.be

Welke vragen moeten doorgegeven worden?	Naar waar?
<p>Vragen met betrekking tot de levering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevestiging van testaanvraag / levering van het testmateriaal. • Bevraging rond tijdstip levering. • Wijziging van het aantal gevraagde testen. • Opmerkingen rond levering (e.g. levering niet gebeurd of onvoldoende materiaal geleverd). 	<p><i>[Tot 30/11]</i></p> <p>Voor Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Luik, Namen, Luxemburg Brussel, Duitstalige Gemeenschap:</p> <p>PPD Global Central Labs</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02 808 38 43 • BEGV.COVID-19.sm@ppdi.com
<p>Vragen met betrekking tot het testmateriaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opmerkingen met betrekking tot het geleverde materiaal (e.g. klachten over het geleverde materiaal). • Aanvraag om ongebruikt testmateriaal te komen ophalen. 	<p>Voor West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Henegouwen:</p> <p>BARC / Cerba Research</p> <ul style="list-style-type: none"> • 09 240 94 44 • COVID-19@cerbaresearch.com
<p>Vragen met betrekking tot de pick-up van de afgenomen samples:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevestiging van de pick-up (ophalen van de afgenomen stalen). 	<p><i>[Vanaf 1/12 zal dit wijzigen en dit document zal dan upgedate worden]</i></p>

<ul style="list-style-type: none"> • Bevraging rond tijdstip pick-up. • Wijziging van het pick-up moment. • Opmerking rond pick-up (e.g. pick-up niet gebeurd). • Nood aan bijkomende pick-up. 	
<p>Vragen met betrekking tot de reserveringstool</p> <ul style="list-style-type: none"> • Authenticatie • ... 	https://www.corona-tracking.info/triagecentra/gebruikshandleidingen-reserveringstool/
<p>Vragen met betrekking tot de collectiviteitentool</p> <ul style="list-style-type: none"> • Authenticatie • ... 	https://www.corona-tracking.info/wp-content/uploads/2020/10/Voorschrijftool-Manual-NL.pdf
<p>Vragen met betrekking tot de testresultaten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ontbrekende testresultaten • Non-conform / invalid testresultaten • Vraag naar CT-waarden • ... 	<p><i>Memo</i> 02 223 00 00 tech@memo.be</p> <p>die dan doorverwijst naar FAGG applicatie team of betrokken lab.</p>

Annex 1

Instructiefiche voor gebruik Diagenode tubes



Instructions kit
swab NL